


So verbindet Österreich !!


Habt ihr auf eurer Station einen schriftlichen Verbandsstandard ?

Anzahl Antworten: 57

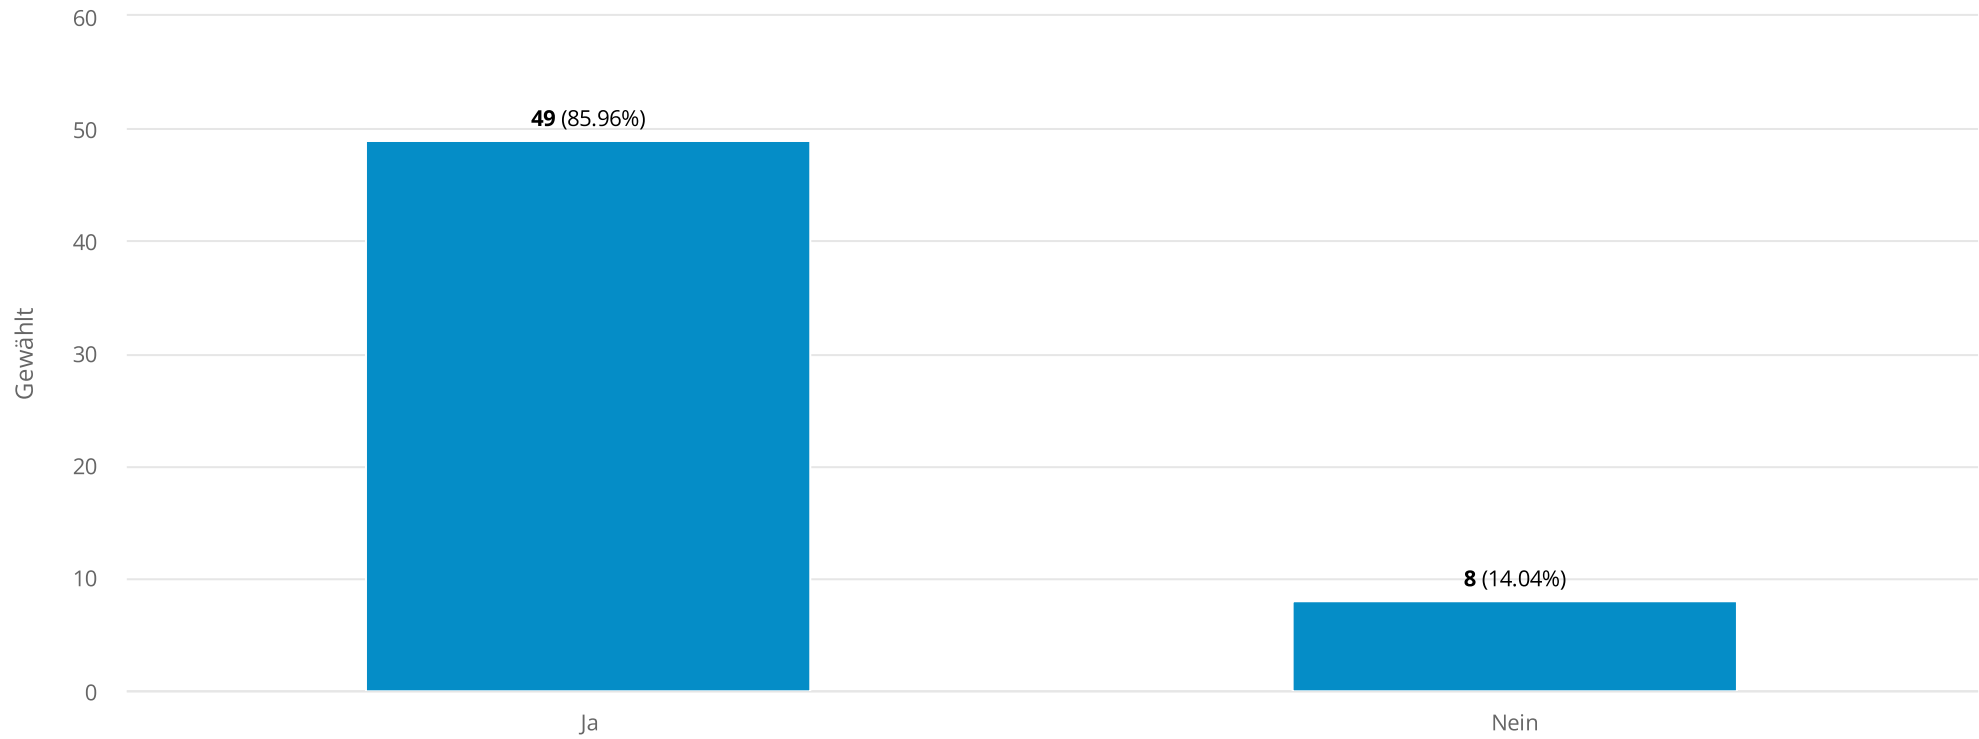


Ist euer Standard nach Einstichstellen klassifiziert (z.B. EST 1-4)

Anzahl Antworten: 49

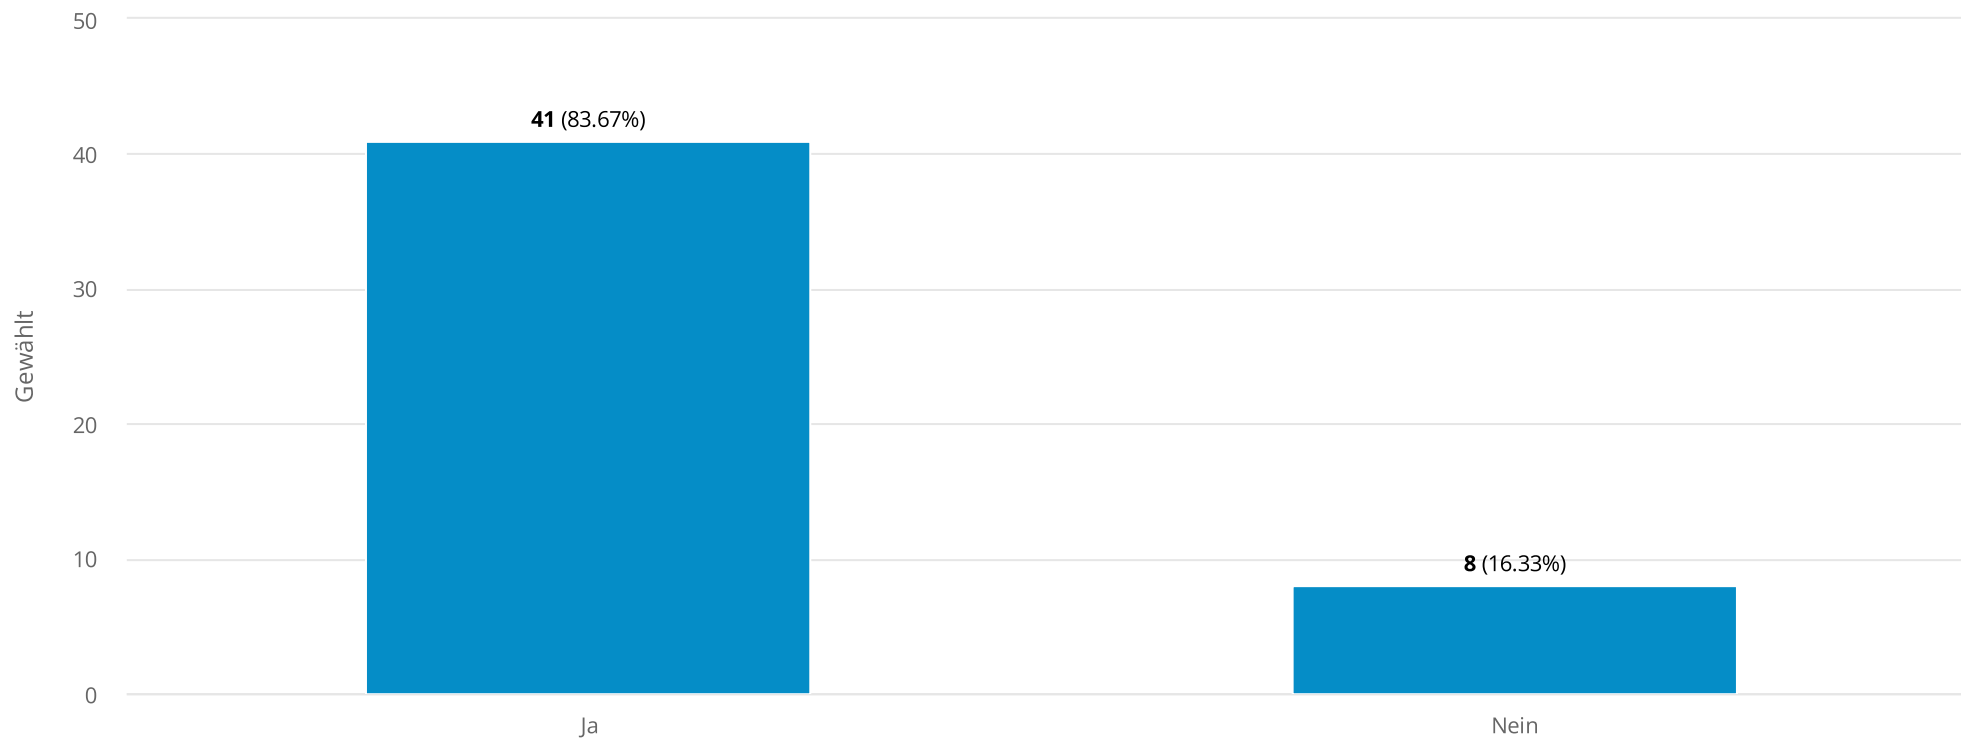


Enthät diese Klassifizierung Beispielfotos ?

Anzahl Antworten: 49

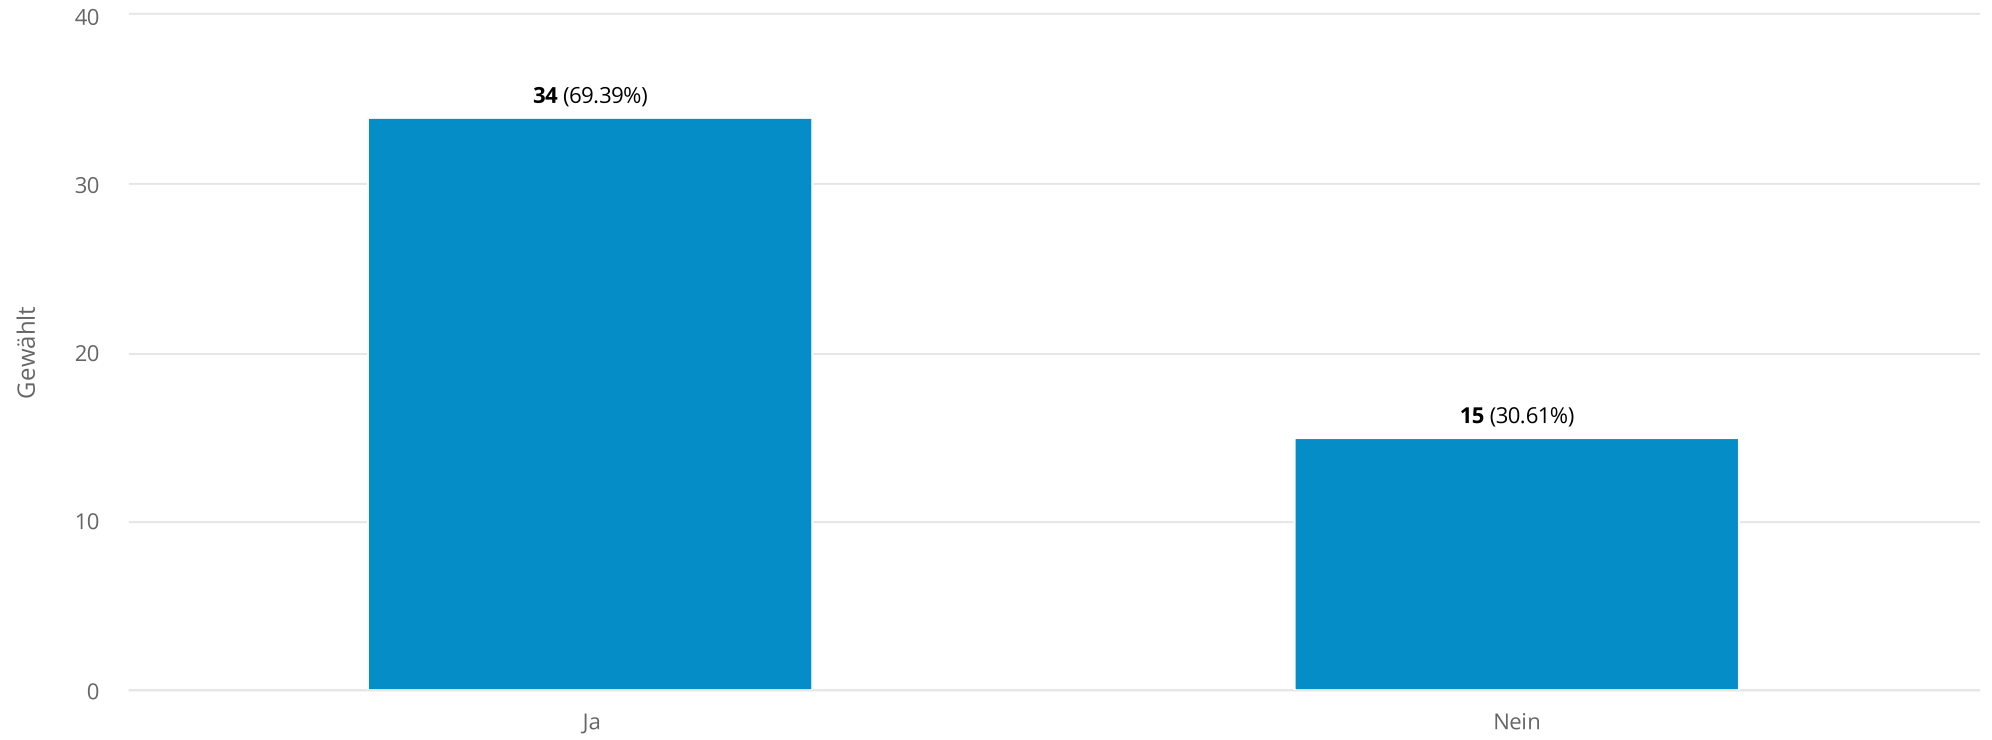


Wird je nach Klassifizierung eine Vorgangsweise (Desinfektion, Verbandstoff,...) beschrieben?

Anzahl Antworten: 49

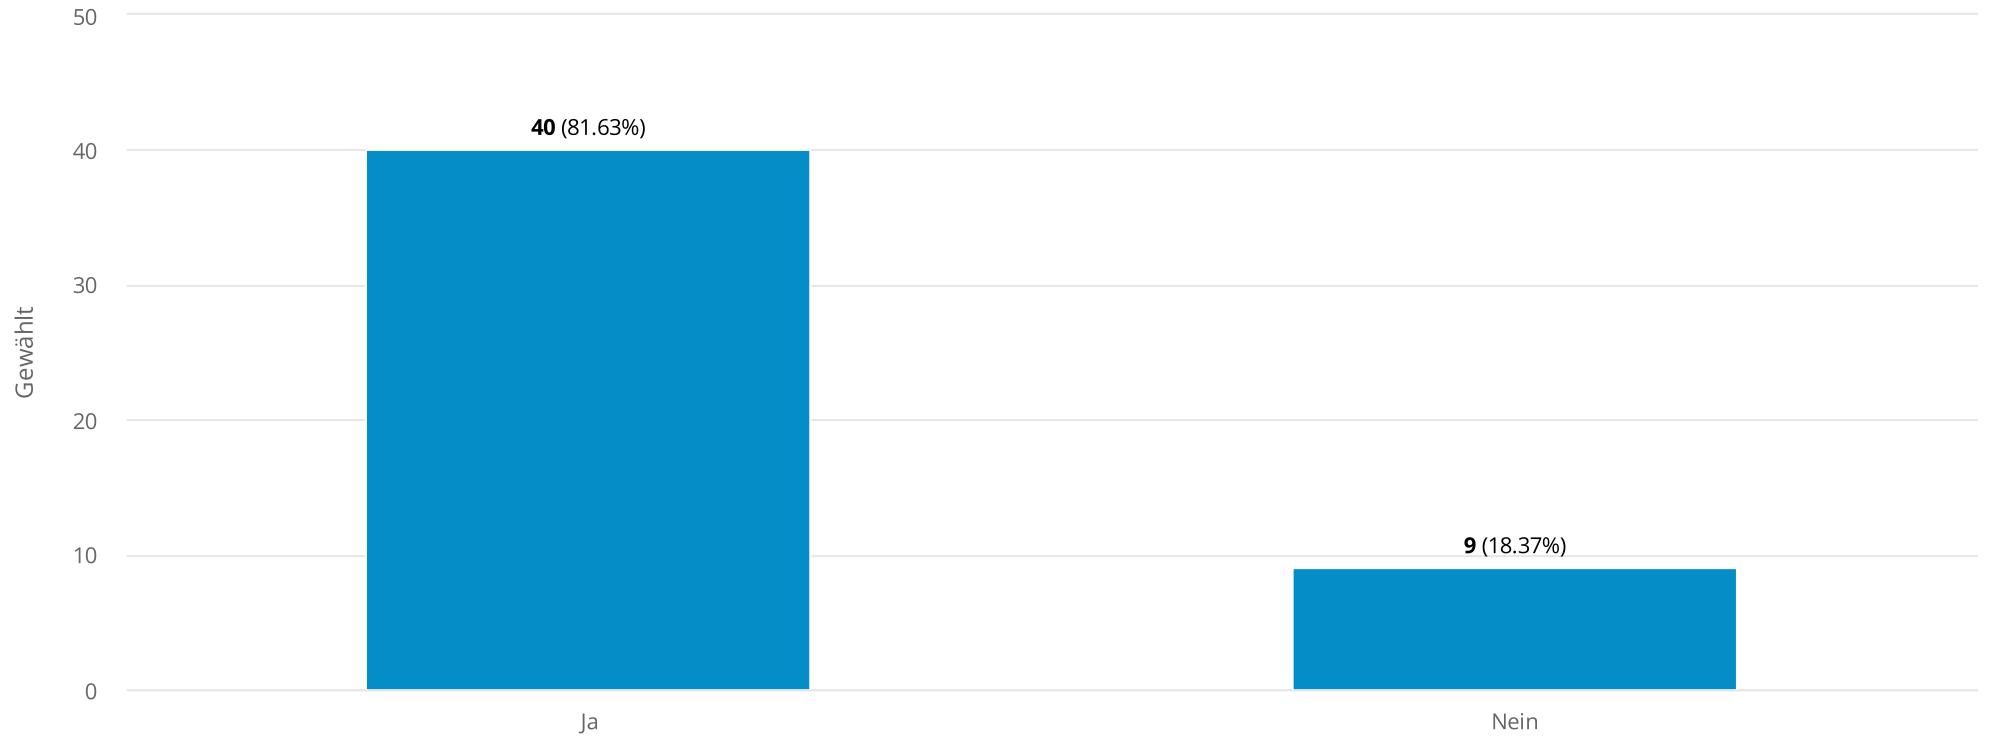

WAS genau ?

Anzahl Antworten: 57

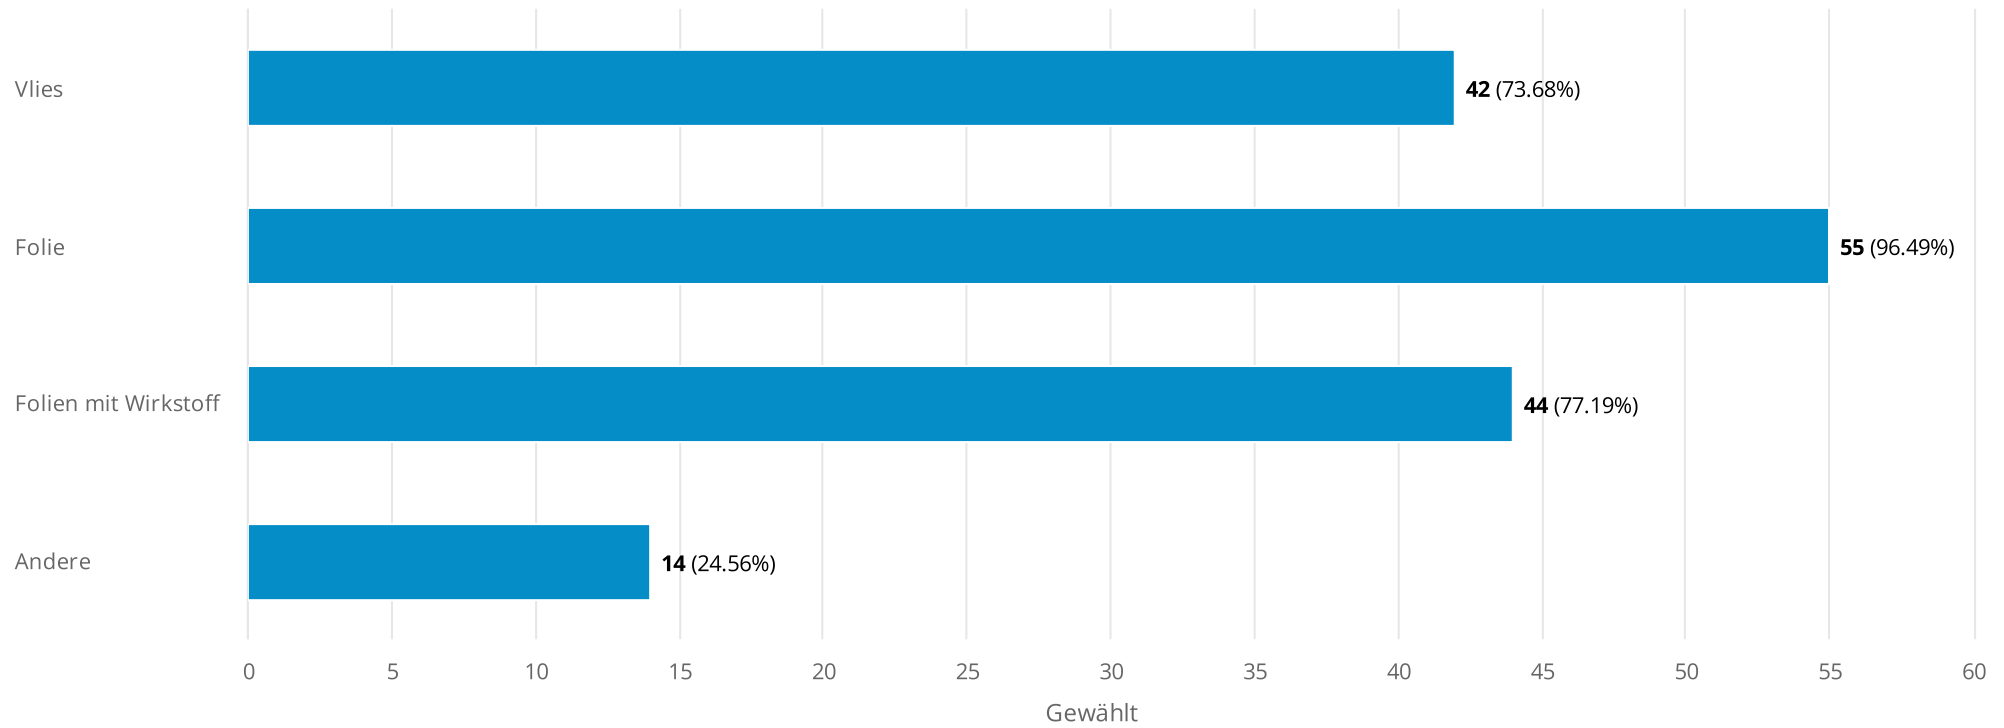

"Andere" Text Antworten:

Biopatch

Andere

ohne Verband

ohne Verband

ohne Verband

Mepilex border bei Unverträglichkeit des Klebstoffes

Mepilex Border, Folienverband mit Tupfer ad Kast

Folie + Biopatch

CHG

Ohne VB

Gaze


exit-pro ag

Schlitztupfer oder Curapor Verband

Pflasterverband

Gibt es diesbezüglich ein Informationsblatt für Patient*innen

Anzahl Antworten: 57

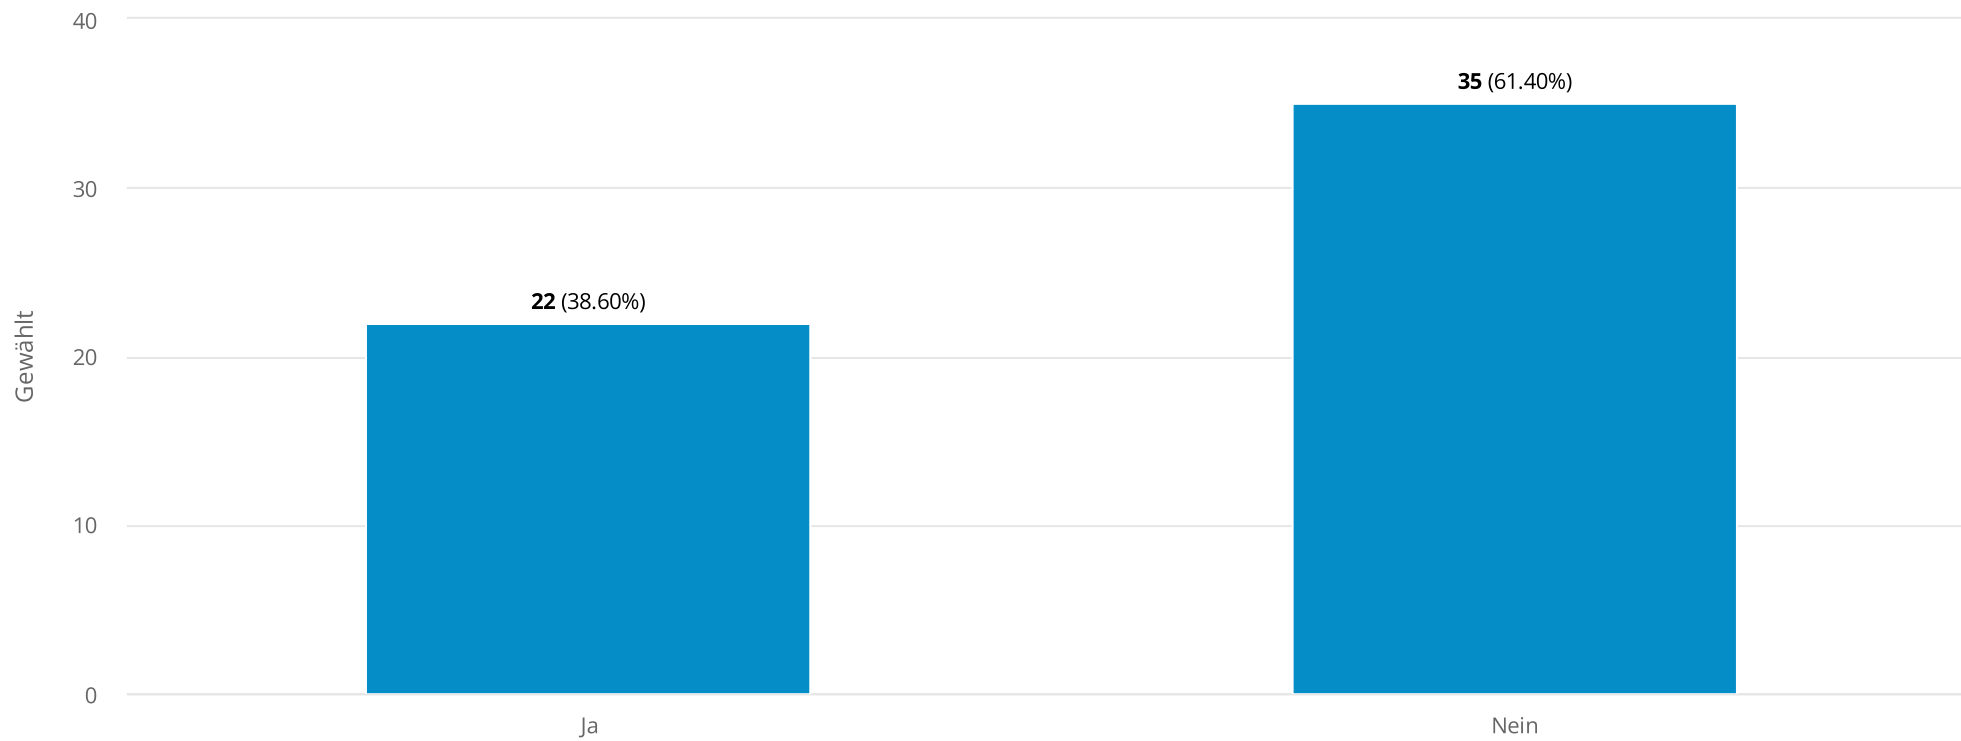

Welcher Hersteller ?

Anzahl Antworten: 27

Text Antworten:

Hartmann

Lohmann und Rauscher

Hartmann

Hartmann, Leukoplast

Curapore

FA.Hartmann

verschieden, da für zu hause andere Hersteller geliefert werden; Hersteller im KH ok, zu Hause nicht immer ok;

Paul Hartmann AG

Smith&Nephew

Hartmann

Hartmann

Mepore

Cosmopore

Cosmopor

Hartmann

Cosmopore E

Cosmopor Hartmann

CosmoporE

Hartmann

Hartman,3M Deitschlanu

Lohmann & Rauscher

Mepore

Hartmann

Lohmann & Rauscher


Hartmann

Lohmann&Rauscher

Cosmopor


Bist du mit dem Handling/Material zufrieden?

Anzahl Antworten: 42

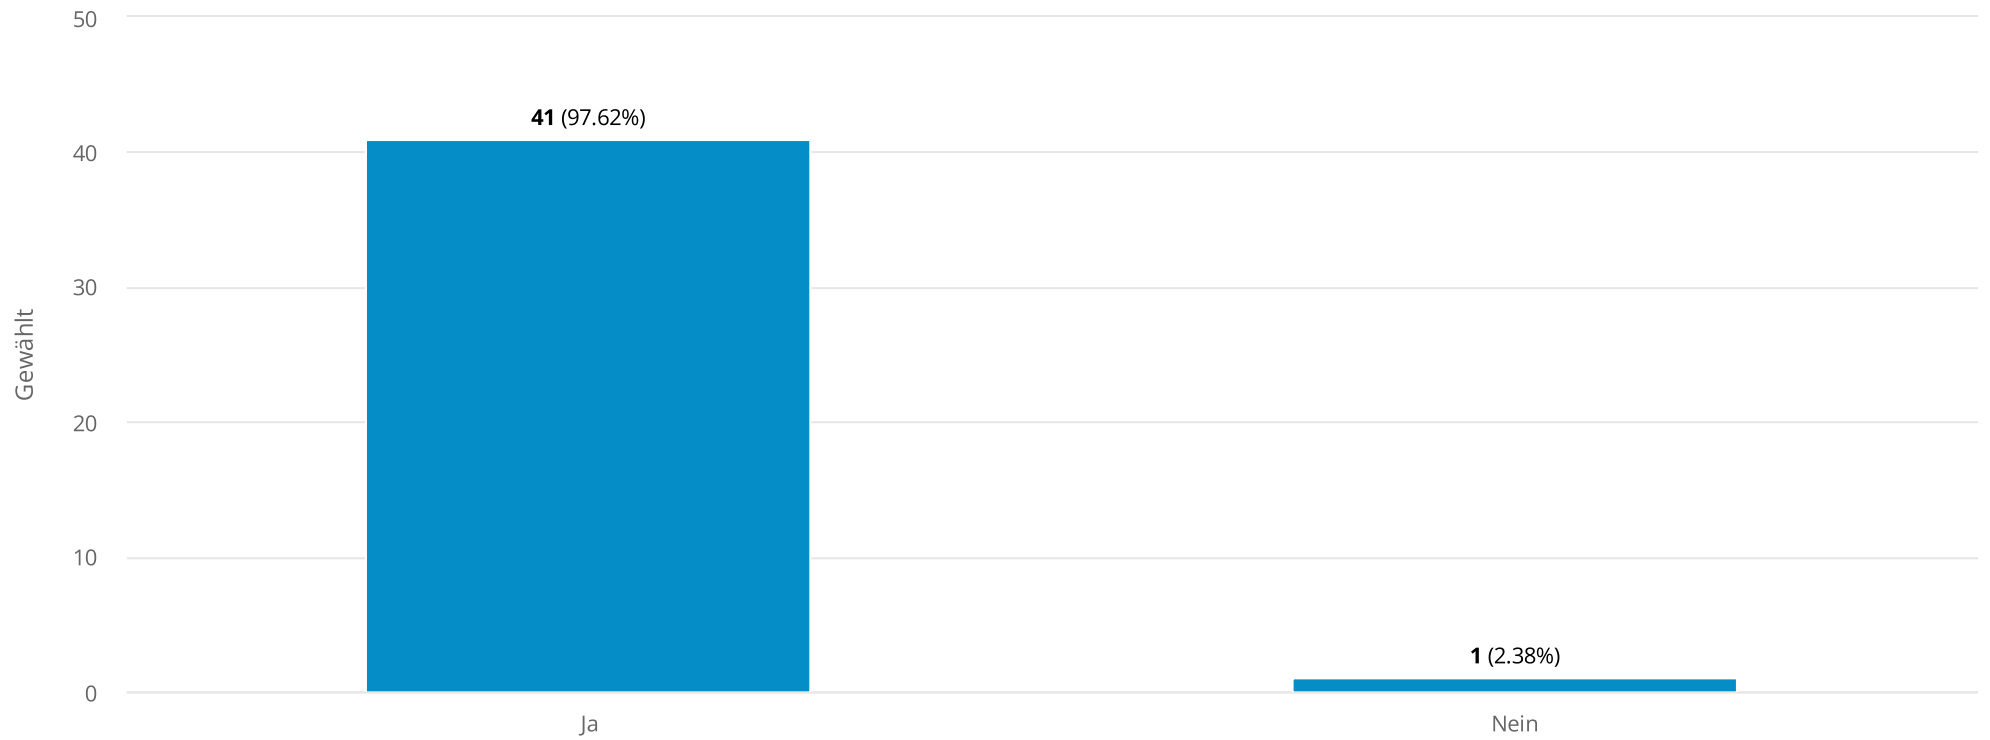

Wenn deine Antwort NEIN ist , warum kann es nicht geändert werden ?

Anzahl Antworten: 1

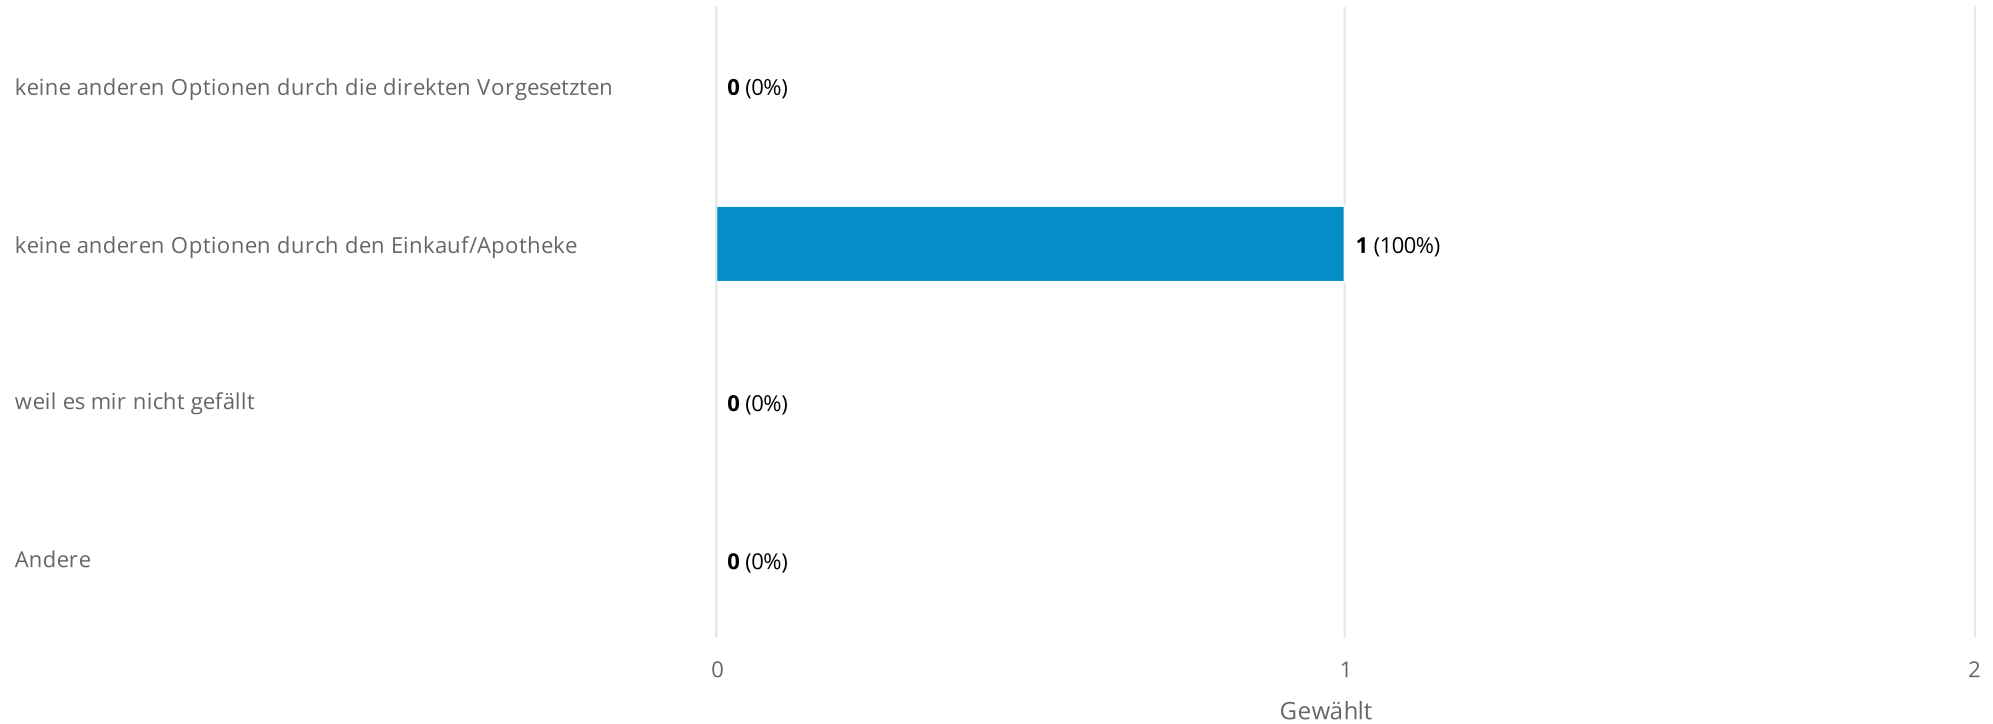

Welcher Hersteller ?

Anzahl Antworten: 41

Text Antworten:

Smith&Nephew (IV3000)

smith and nephew

IV 3000

3M

smith&nephew, 3M

Smith & Nephew

IV 3000

3M Deutschland GmbH Health Care Business

3M Deutschland GmbH Health Care Business, Smith & Nephew Medical Limited

Cocmopor E von Fa. Hartmann und IV3000 von Fa. smith&nephew

Smith&nephew

M3

3M

iv3000

Iv3000

IV 3000

Smith & Nephew

iv 3000

Mepiltac und Fixomull Transparent

Verschiedene

Tegaderm 3M

Tegaderm

3m

3M

Hartmann, 3M

Hartmann, 3M

diverse

Verschiedene, je nach Patientenverträglichkeit

IV3000

smith & nephew

Tegaderm

smith&nephew

smith&nephew

Smith& Nephew

Tegaderm

3M

Smith&Nephew

Opseit


Tegaderm, iV 3000

Smith&Nephew - IV 3000

smith&nephew


Bist du mit dem Handling/Material zufrieden

Anzahl Antworten: 55

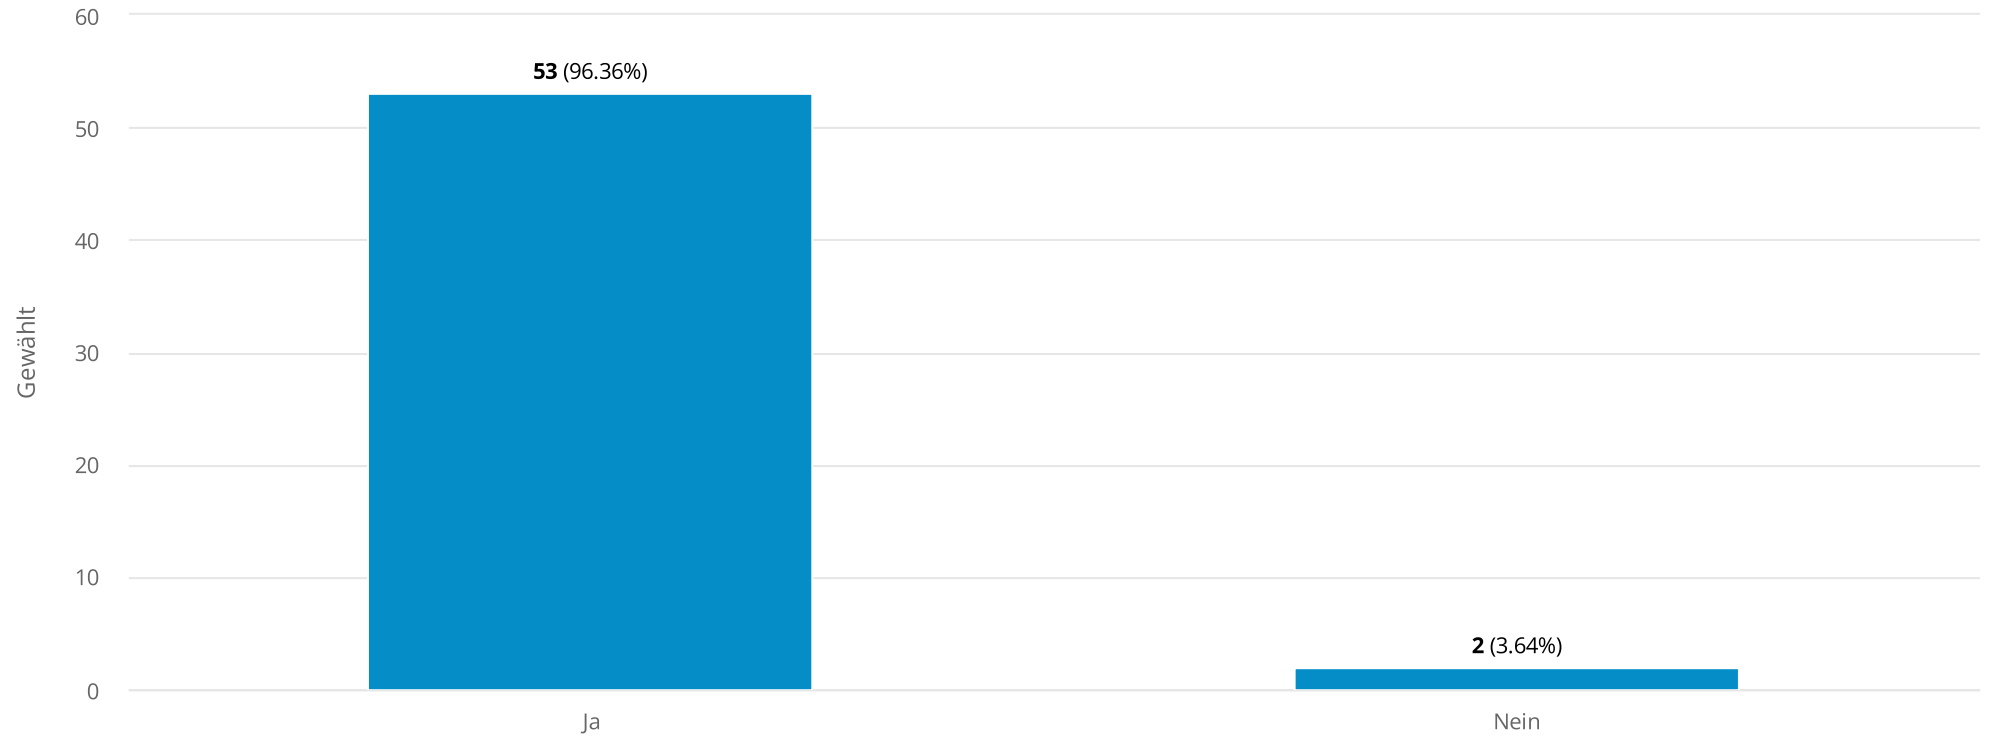

Wenn deine Antwort NEIN ist , warum kann es nicht geändert werden ?

Anzahl Antworten: 2

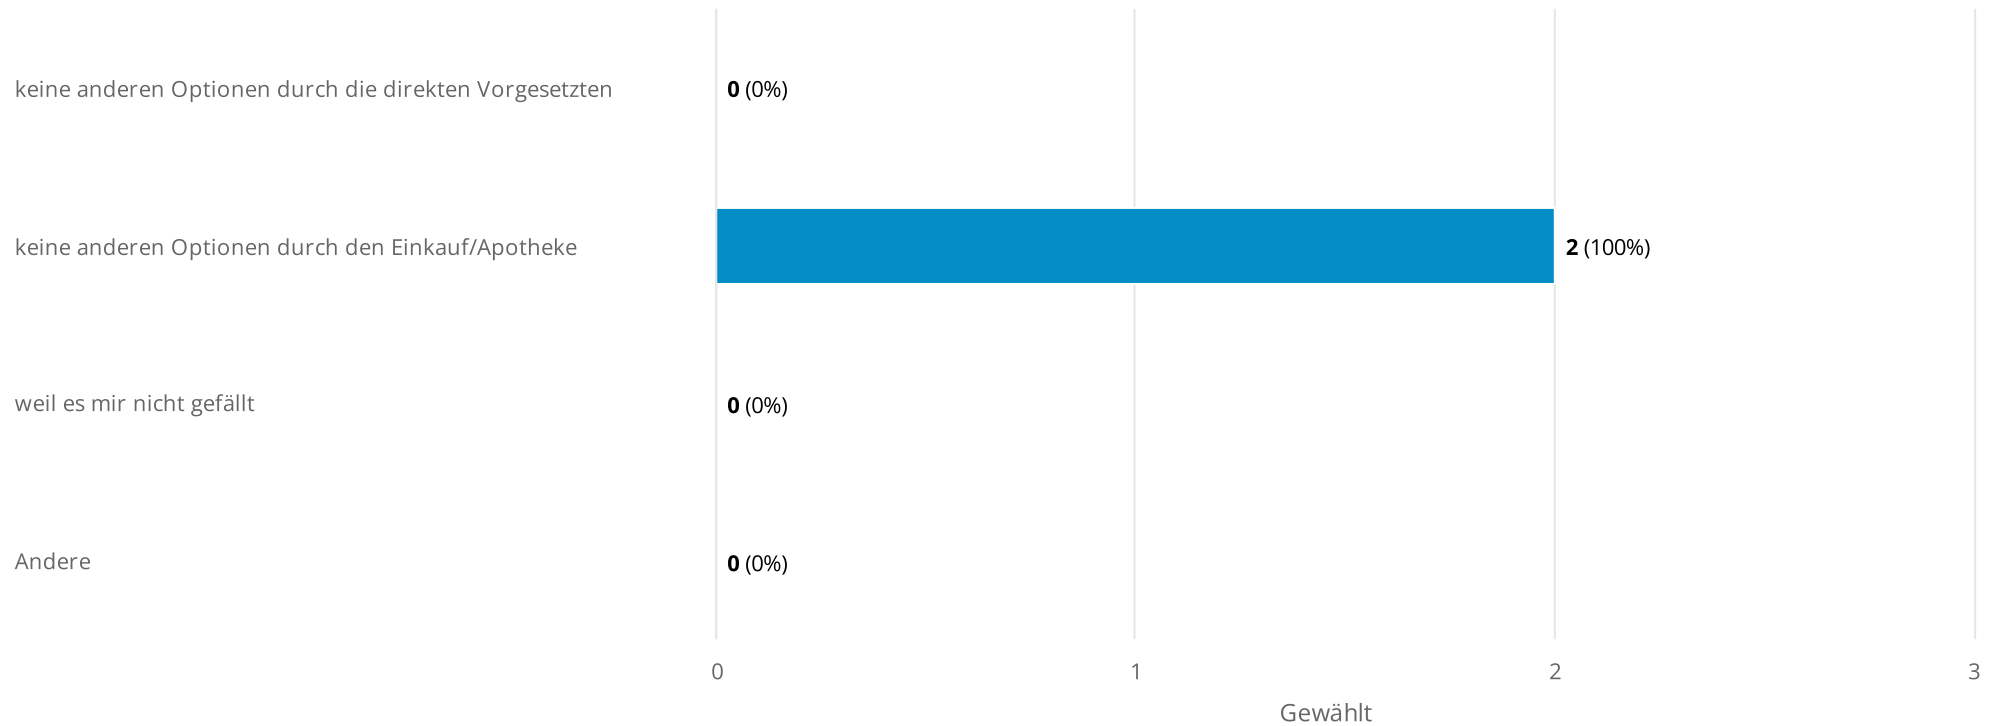

Welcher Hersteller ?

Anzahl Antworten: 31

Text Antworten:

3M (Tegaderm CHG)

3M

CHG

3M

3M

Fresenius Kabi

CHG tegaderm

3M Health Care Canada Company

M3

3M

tegaderm

3m

3M

Smith & nephew

Tegaderm CHG

CHG

Tegaderm CHG 3M

Tegaderm

3m

3M

3M

3M; Tegaderm CHG

Tegaderm

?

Tegaderm CHG

Smith&Nethew

3M

3MHealth Care


IV3000

3M

Tegaderm CHG


Bist du mit dem Handling/Material zufrieden?

Anzahl Antworten: 44

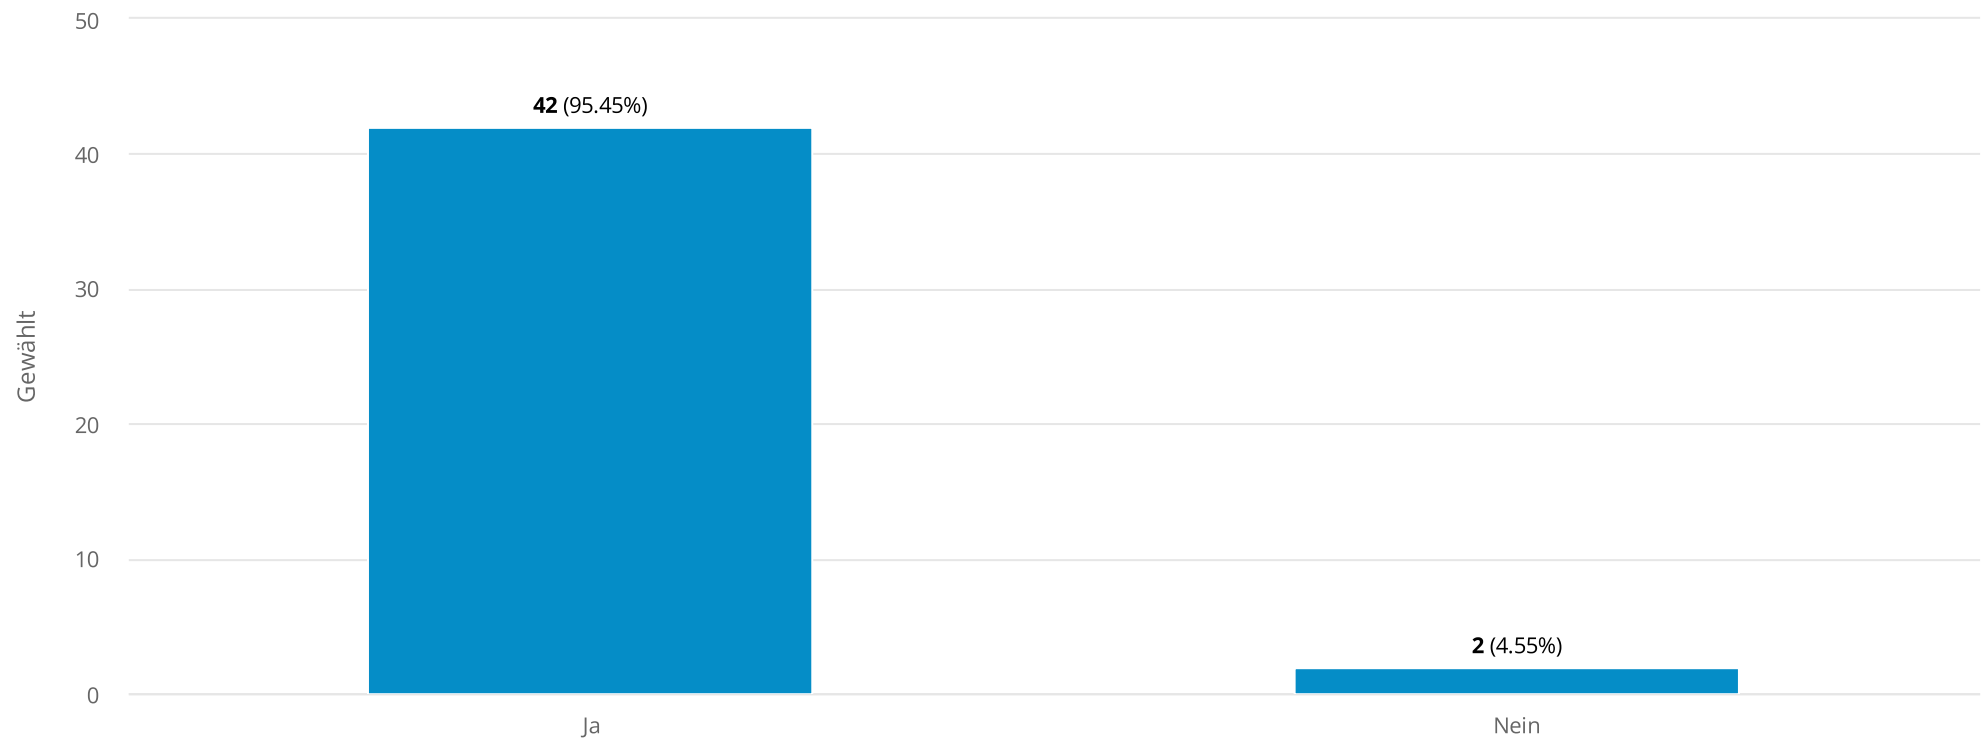

Wenn deine Antwort NEIN ist , warum kann es nicht geändert werden ?

Anzahl Antworten: 2

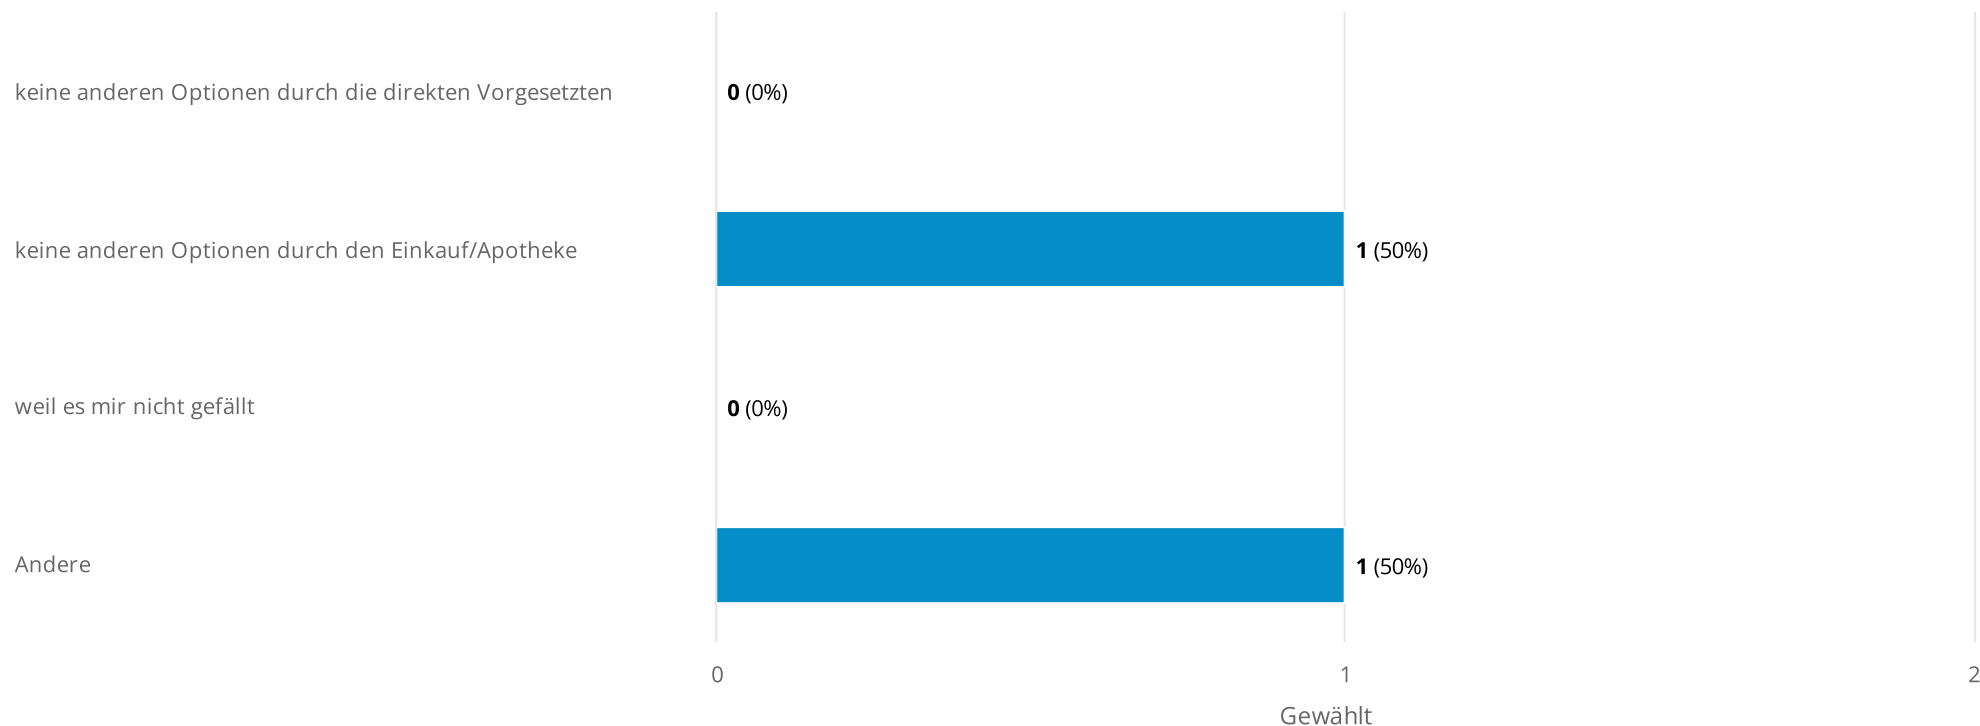

"Andere" Text Antworten:

macht Rückstände bei Katheter

**Könnt ihr vielleicht ein besonders schönes Verbandfoto (mit Einverständnis der Patient*innen) hochladen ? Habt ihr keine Foto gespeichert? Dann überspringt bitte hier und macht OHNE Fotos den Fragebogen fertig - DANKE !
Wollt ihr dann doch noch Fotos schicken, dann kontaktiert mich - Claudia.mayer@akhwien.at**

Anzahl Antworten: 0

Noch keine Antworten gesammelt


Könnt ihr vielleicht ein "misslungenes" Verbandfoto (mit Einverständnis der Patient*innen) hochladen ?

Anzahl Antworten: 1

Wo ist KAST.jpg (110 KB)


Habt ihr Patient*innen die KEINEN Verband haben ?

Anzahl Antworten: 57

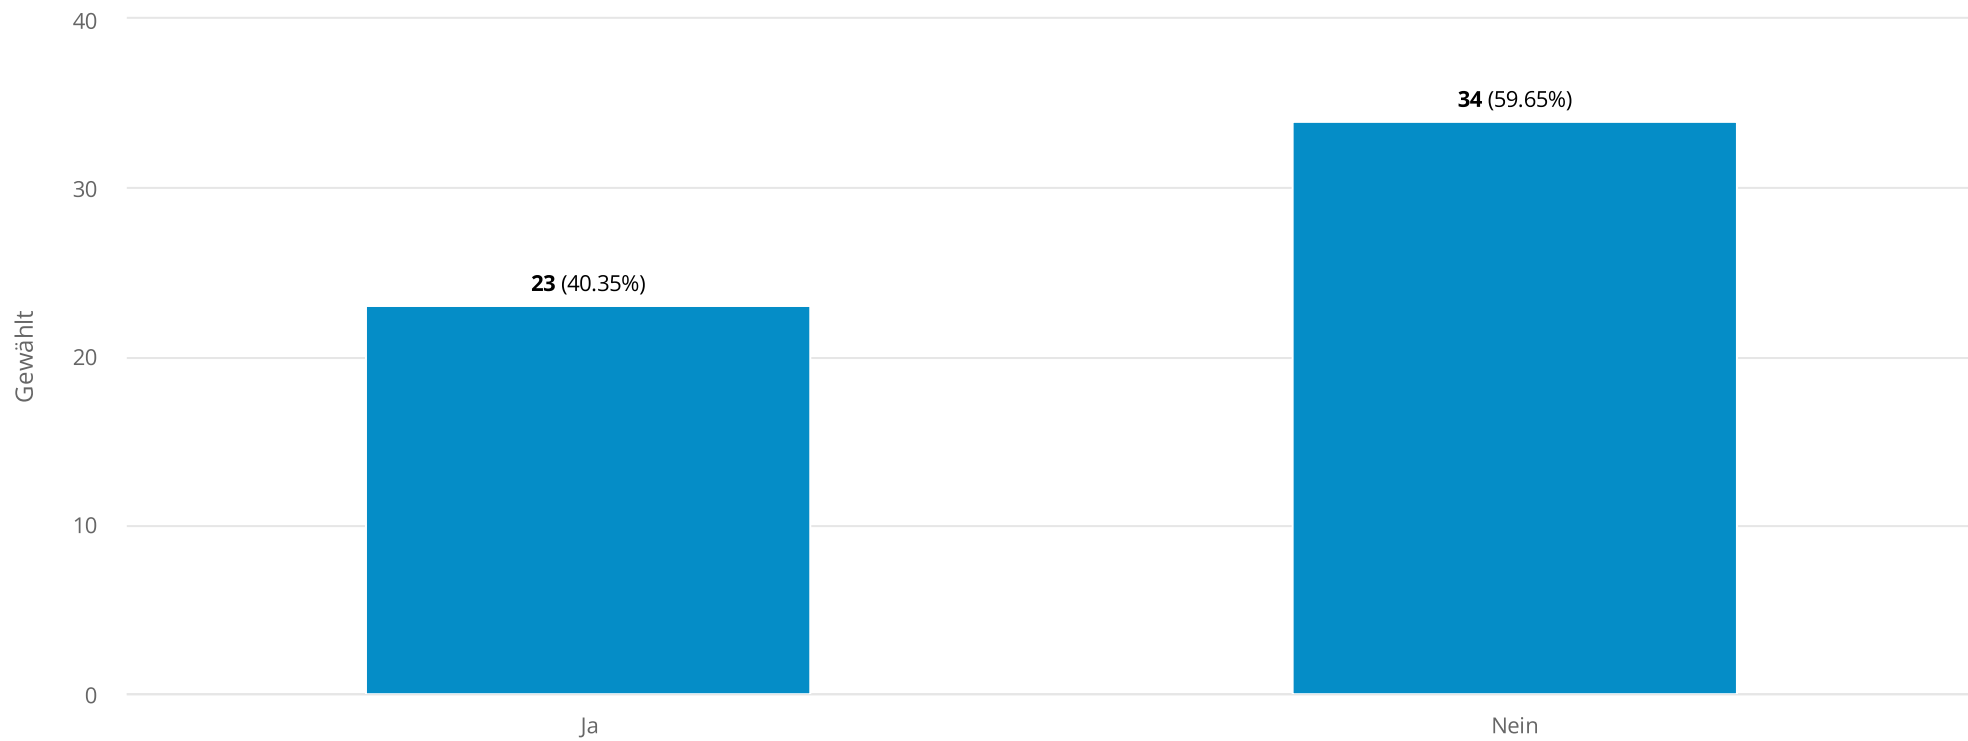

Wenn JA , welche Kriterien sind für die Auswahl ausschlaggebend ?

Anzahl Antworten: 23

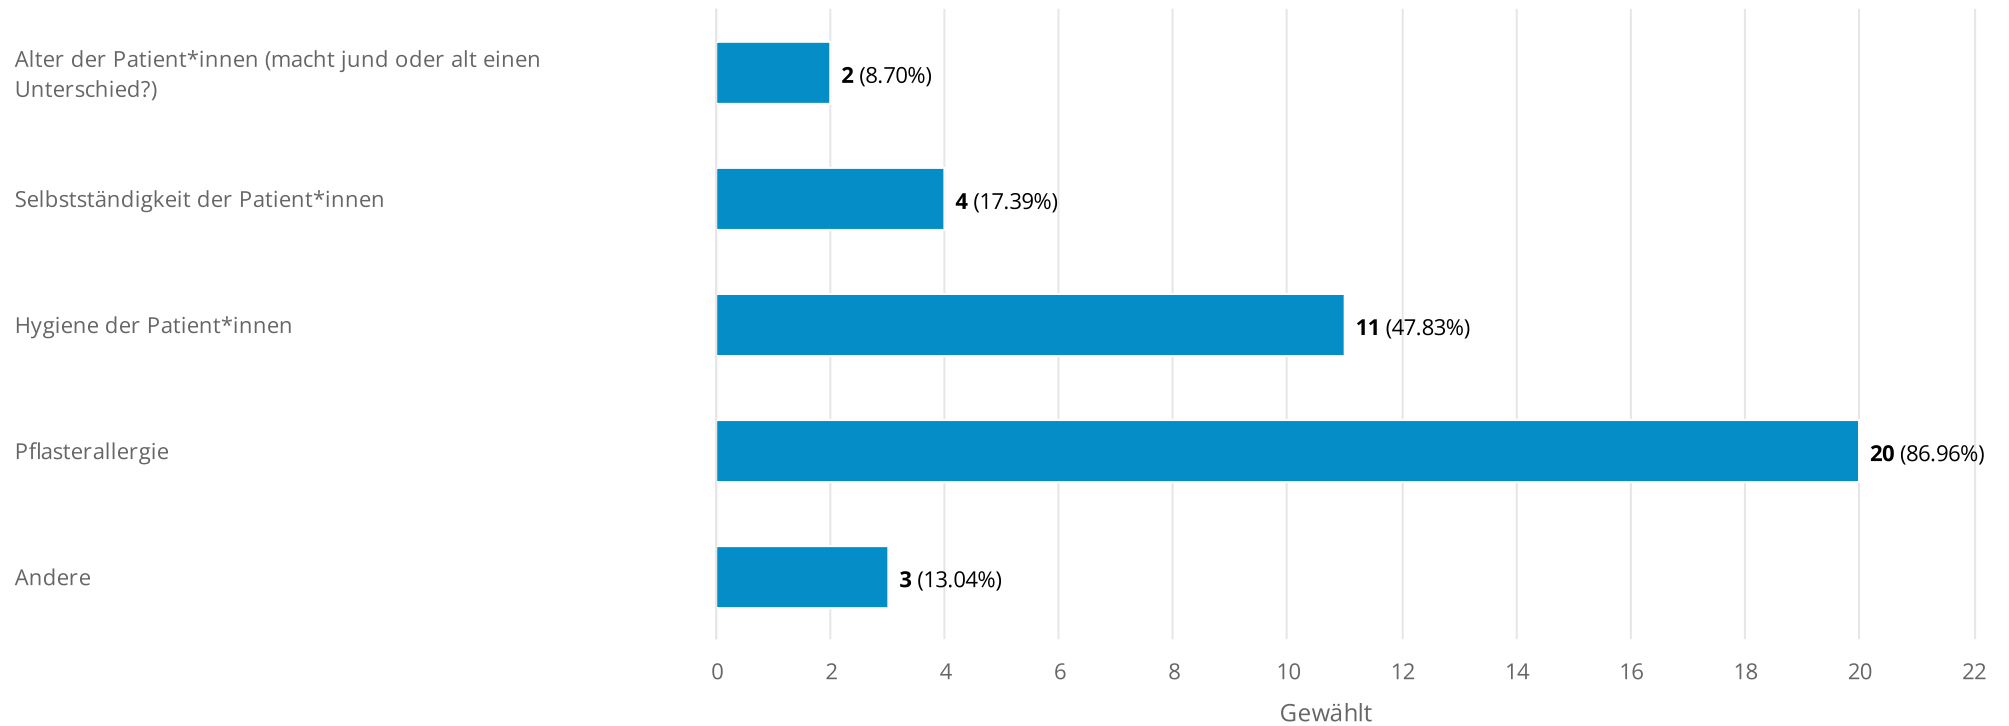

"Andere" Text Antworten:


Wenn Pat. gerne schwimmen gehen

Wunsch des Patienten

Siehe Empfehlung Katheter VW auf der öanpt homepage

Gibt es diesbezüglich ein Informationsblatt für Patient*innen

Anzahl Antworten: 23

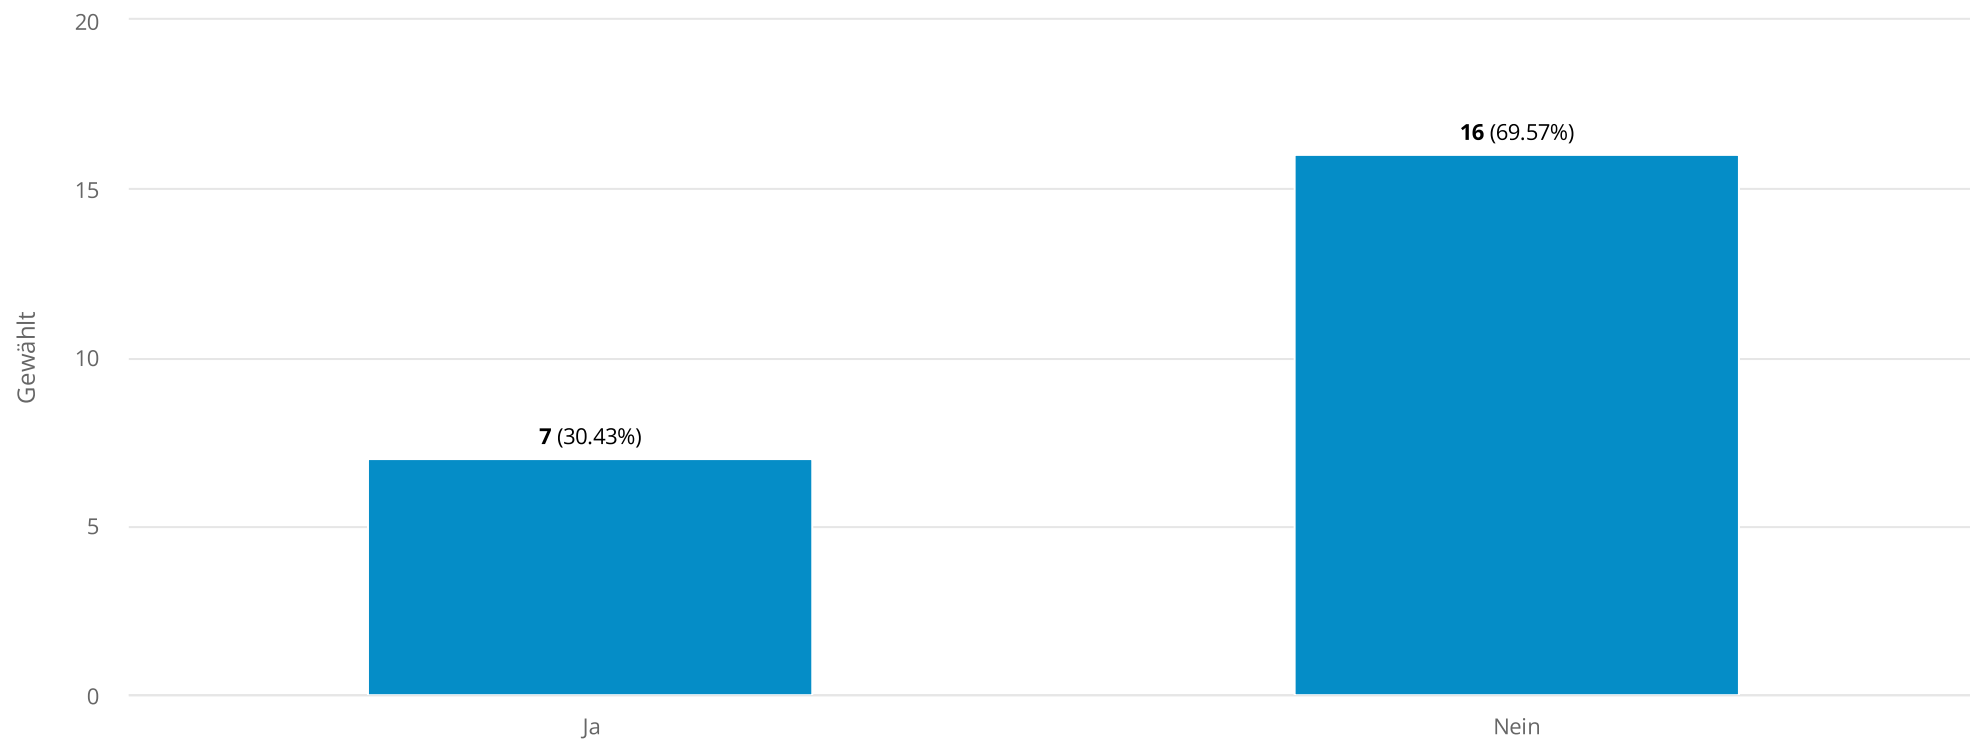


Können Sie vielleicht ein Foto (mit Einverständnis der Patient*innen) hochladen

Anzahl Antworten: 0

Noch keine Antworten gesammelt


Haben eure Patient*innen Duscherlaubnis ?

Anzahl Antworten: 57

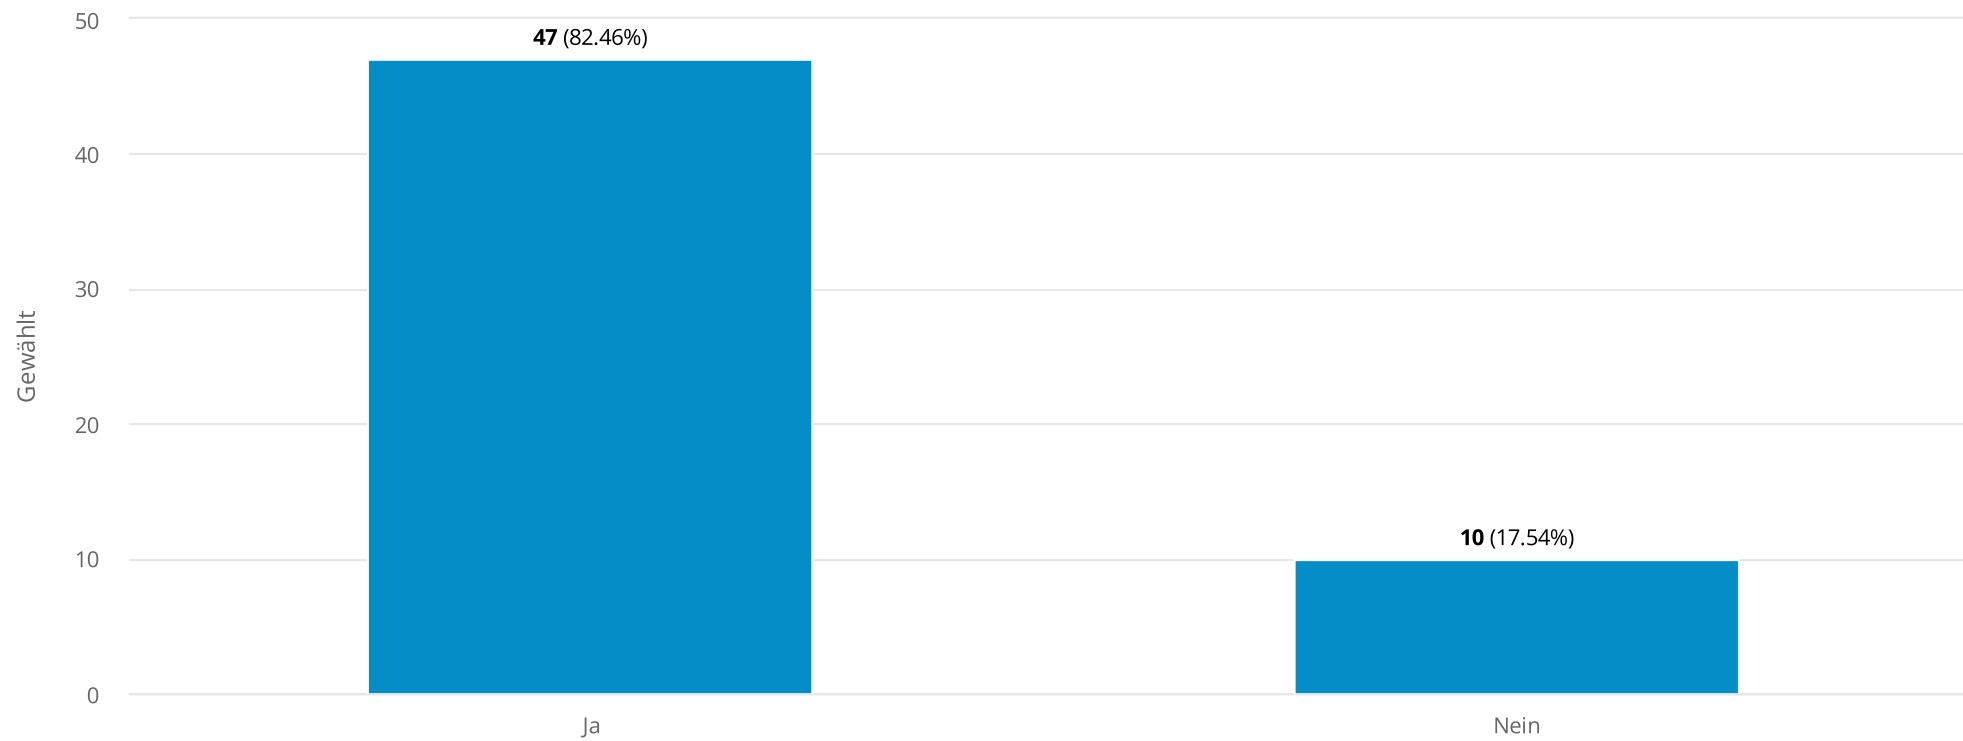

Welche Duschverbände werden verwendet?

Anzahl Antworten: 47

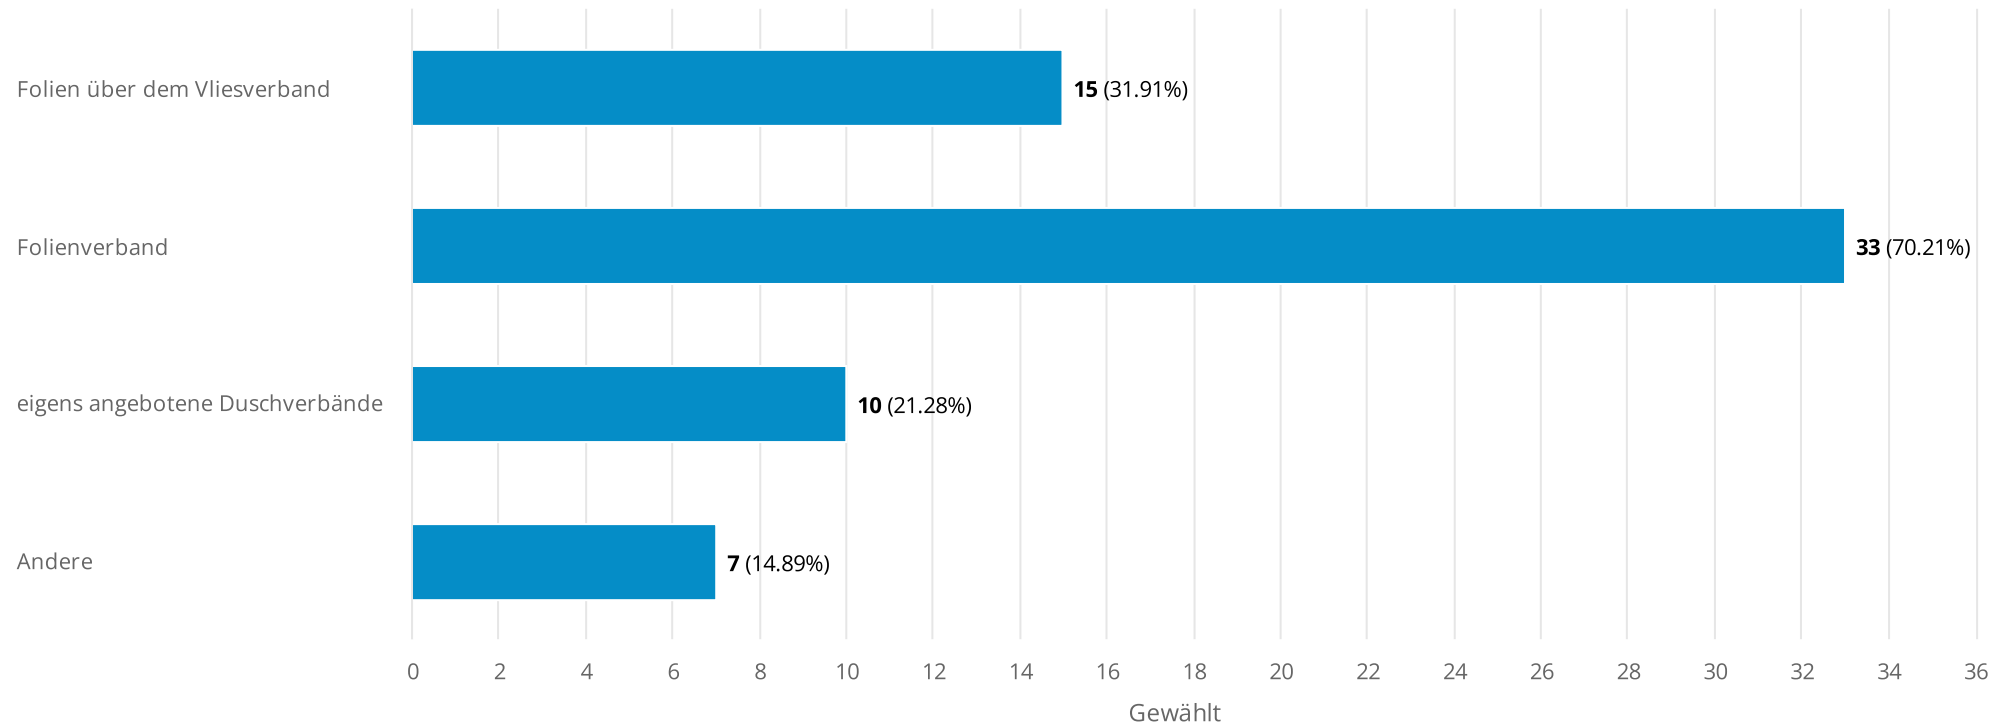

"Andere" Text Antworten:

kein Verband beim Duschen, Reinigung mit Octenidin oder Betaseife (je nach Verbandwechselstandard), danach Verbandwechsel

mit Tiefkühlsackerl den Verband großflächig überkleben

Offen

Pat müssen diesen selber käuflich erwerben, wir unterweisen sie lediglich im Handling


Andere

offen

Für Duschverbände ist PatientIn verantwortlich


Gibt es ein Informationsblatt für Patient*innen wie sie mit einem losen oder nassen Verband umgehen sollen ?

Anzahl Antworten: 57

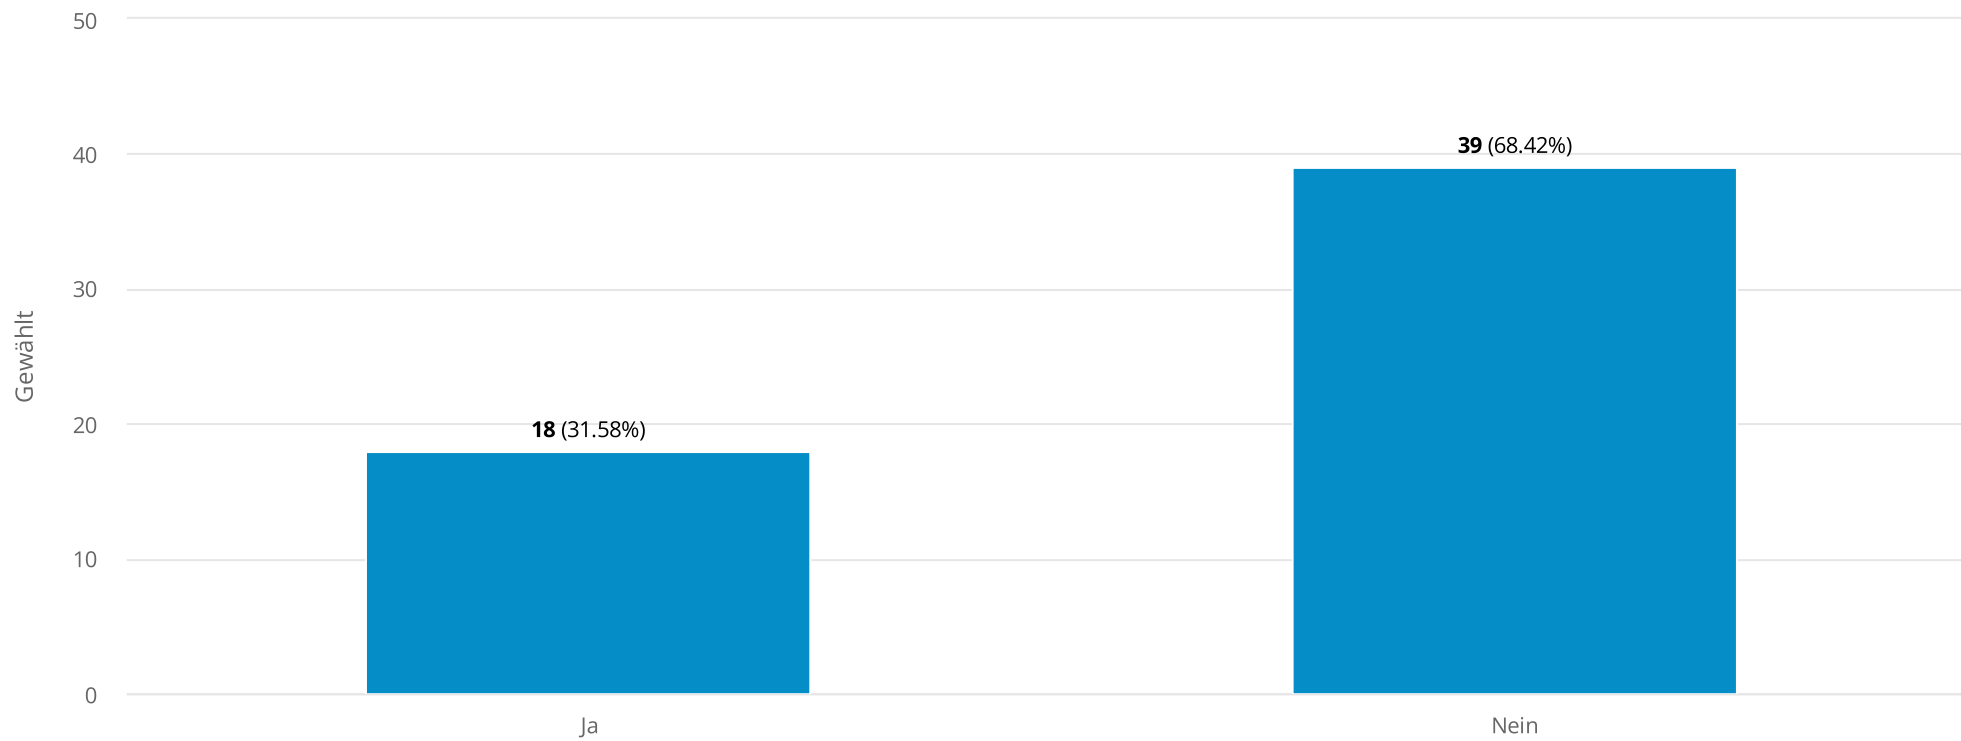

Verwendet ihr Konnektoren mit Rückschlagventil ?

Anzahl Antworten: 56

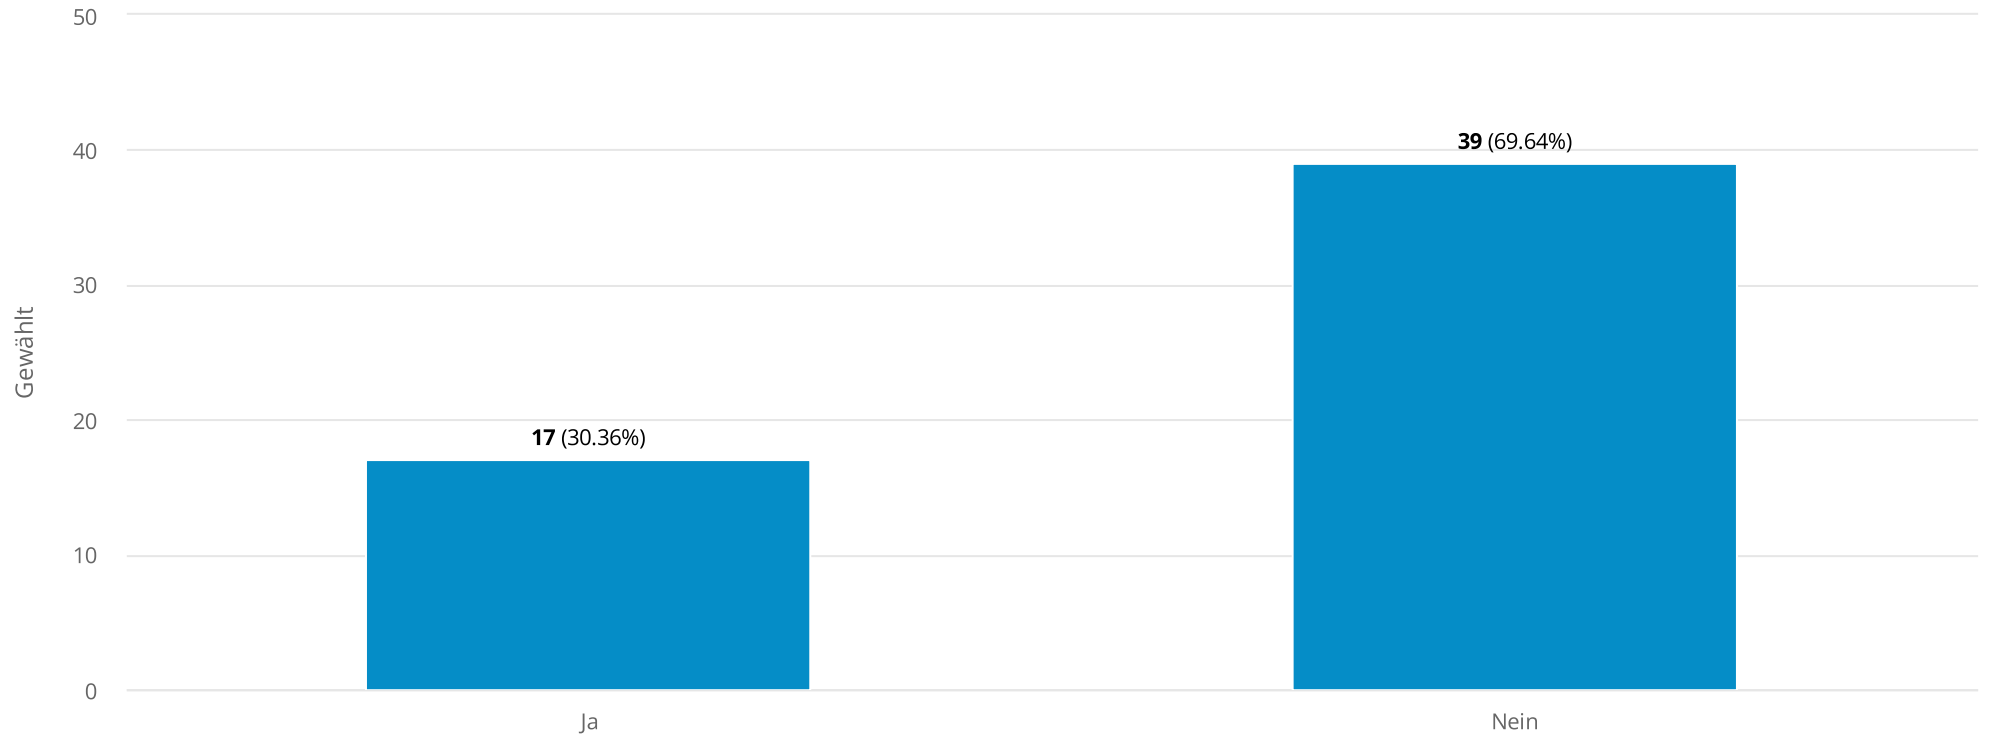

Welcher Hersteller ?

Anzahl Antworten: 13

Text Antworten:

Tegu

BBraun

TEGO Connector FA- Medical

IDU Medical

asset

asset

Flow art

Asset Medical

Asset Medikal

Tego


ICU Medical Inc.

Tego

FlowArt über Biomedica

Was hat euch dazu bewogen diese zu verwenden?

Anzahl Antworten: 17

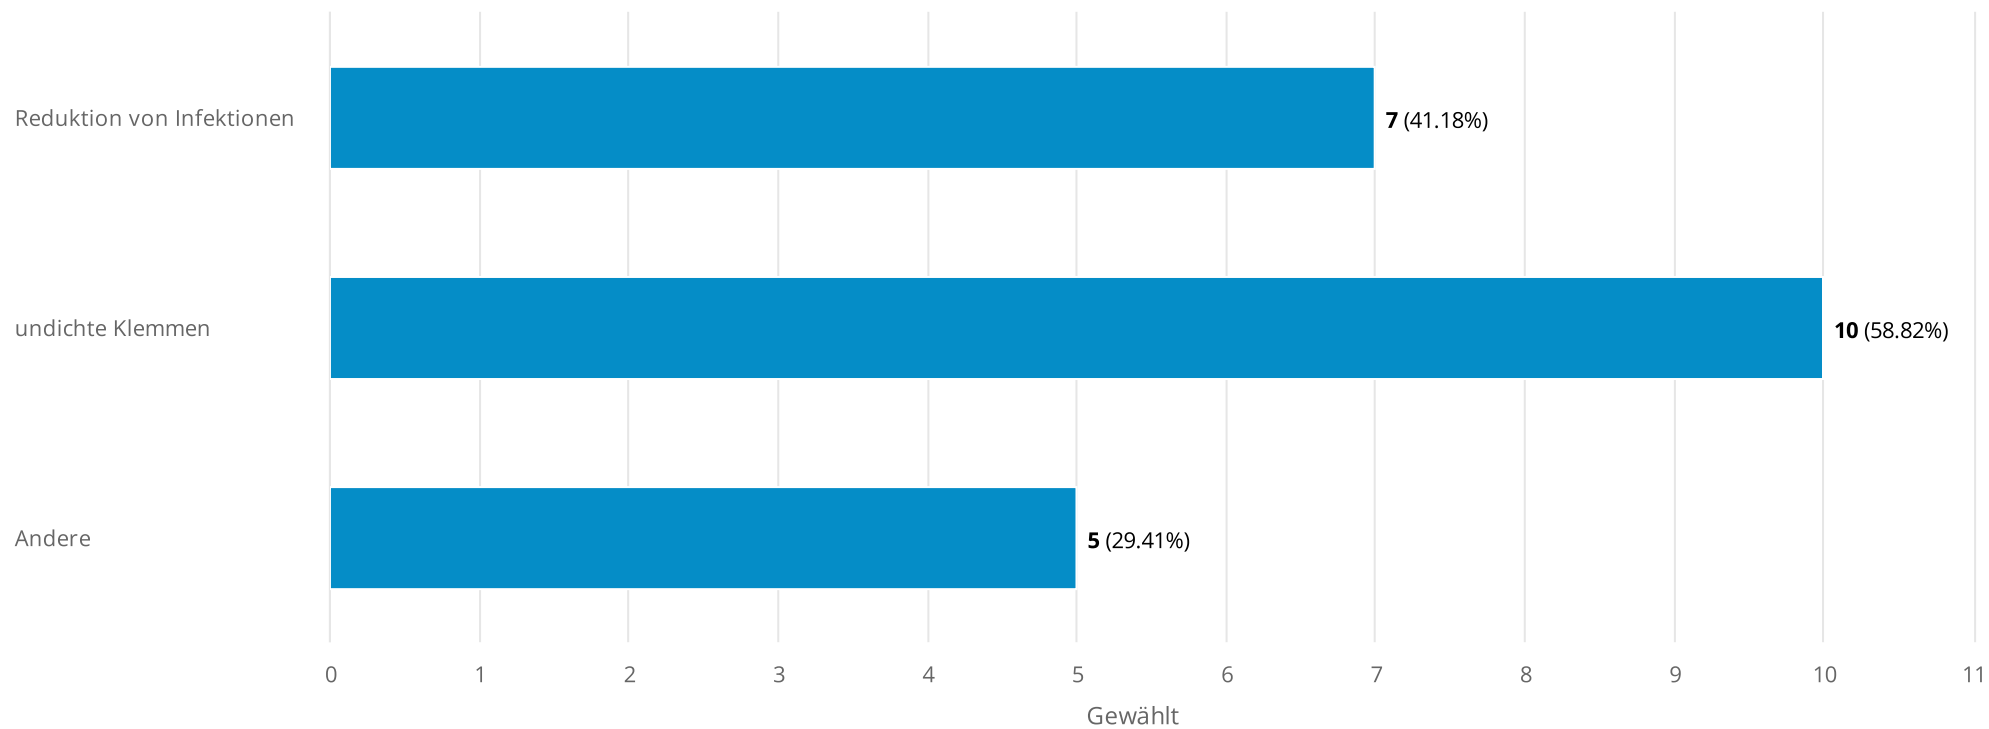

"Andere" Text Antworten:

Hygiene

Reduziertes Wechselintervall


Bruch der Ansatzstücke vom Kath.

Vorfall mit Diskonnektion

Vorfall

Was hat sich als besonders gut herausgestellt?

Anzahl Antworten: 57

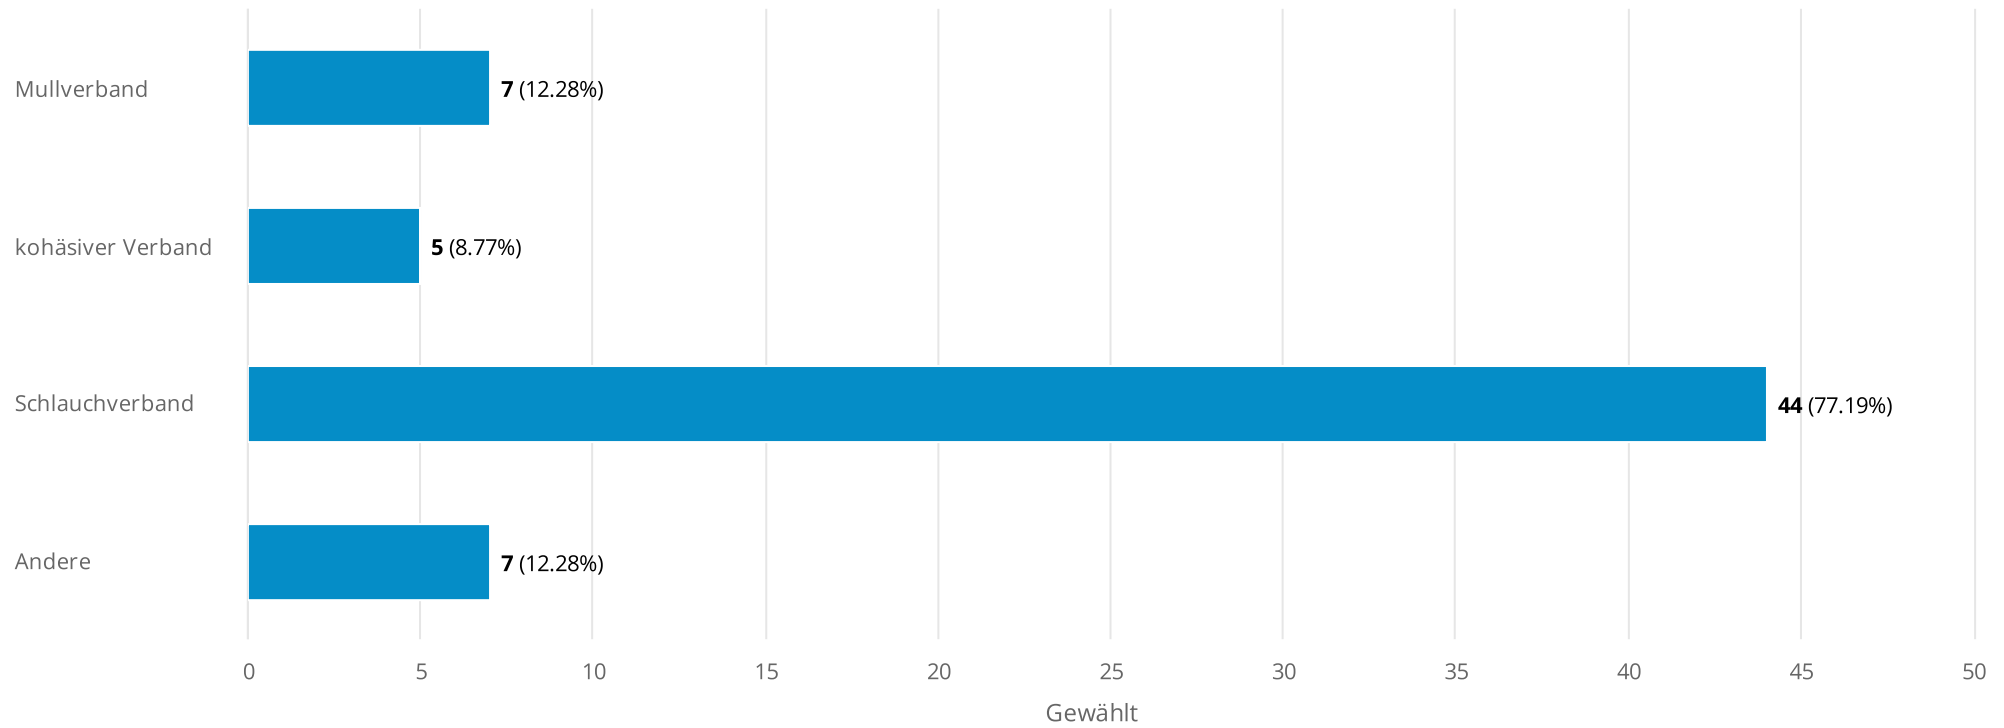

"Andere" Text Antworten:

opercath classic

sterile Mullkompressen

ohne Verband wenn PK gut eingewachsen

Andere

Andere

Nichts

keine

Können Sie vielleicht ein Foto (mit Einverständnis der Patient*innen) hochladen

Anzahl Antworten: 0

Noch keine Antworten gesammelt